研究用試薬　　2013 年 10 月 31 日　改訂

『 レビス® プロインスリン-マウス/ラット 』取扱説明書

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。ご使用に際してはキットに同梱された取扱説明書のみに従って測定を実施して下さい。なお、操作法は弊社 Web サイト[良い結果を出すためのポイント(動画)]、並びに[Q&A]（キットの蓋を開けた際に一番上にあるカード（13×10cm）に記載されたパスワードをご利用下さい）をご参照下さい。

1.使用目的

本キットはマウスまたはラットのプロインスリンを定量的に測定するためのサンドイッチ酵素免疫測定法です。本キットは研究のみにご使用下さい。

特長

●全反応時間は 5 時間です。
●マウスまたはラットの血清または血漿中のプロインスリンを測定します。
●微量な検体（標準操作法は 10μl）で測定可能です。
●1 キットは 96 ウエル（測定に使用するのは 60 ウエル）です。
●標準品はマウス由来のものです。
●全ての試薬は溶液タイプです。

2.キットの保存と使用期限

キットは 2～8℃で保存して下さい（凍結厳禁）。この保存条件下でキットは製造月から 6 ヵ月（外箱のラベルに記載）までは安定です。有効期限の過ぎた試薬は使用しないで下さい。開封した各試薬につきましては、保管状態により影響を受ける可能性がありますので早めのご使用を推奨します。

3.イントロダクション

プロインスリンはインスリンの前駆体で膵島 B 細胞内でアミノ酸 86 個からなる分子量約 9,400 の 1 本鎖の形で合成された後、分泌顆粒に移行する過程で S-S 結合が形成され、さらに酵素分解によりインスリンと C－ペプチドとなります。分泌顆粒には、分解し残りのプロインスリンも 10%程度存在し、顆粒が分泌される際に共に血中に放出されます。プロインスリンの生理活性はインスリンの 5～10%であると言われております。

血中のインスリンや C－ペプチドをイムノアッセイで測定すると、一般的にはこのプロインスリンも測定してしまうことになります。プロインスリンのインスリンに対する割合は、インスリン生合成過程の状況を反映している可能性があります。

NIDDM（II 型糖尿病）では空腹時やグルコース負荷時、共に血中プロインスリンレベルは健常者に比べて高く、インスリンに対する割合も増加し、空腹時血糖値が高い場合や肥満の際にはこの傾向は顕著となります。高血糖による持続的なインスリンの分泌が未成熟分泌顆粒のままで放出される可能性が考えられます。またインスリノーマでは高プロインスリン血症が歴然と現れます。

家族性高プロインスリン血症では遺伝的にプロインスリンからインスリンへの転換酵素の異常やプロインスリン遺伝子の異常により転換酵素の作用を受けないプロインスリンが作られるなどが原因で、分泌顆粒中の IRI の大半をプロインスリンが占めます。甲状腺機能高進の場合も、甲状腺ホルモン過多による糖新生に伴う血糖上昇がインスリン産生放出を促進し分解し残りのプロインスリン放出も多くなります。

4.測定原理

本キットは標準品、検体を抗プロインスリンモノクローン抗体（インスリン部位認識抗体）固相化マイクロプレートウエル中で 2 時間インキュベートします。洗浄後、ビオチン結合抗プロインスリン抗体（C-ペプチド部位認識抗体）を加え、2 時間インキュベートします。再度の洗浄後、ペルオキシダーゼ・アビジン結合物を加え、捕捉されたプロインスリンとともに 30 分インキュベートします。洗浄後、ウエルに残ったペルオキシダーゼを発色液（TMB）と反応させます。反応は酸性の溶液の添加で停止され、反応の結果生じた黄色の産物が 450nm（副波長 620nm）で比色測定されます。吸光度はプロインスリン濃度にほぼ比例します。標準品濃度に対して吸光度をプロットし標準曲線を作製し、この標準曲線から未知検体中の濃度が決定されます。

5.注意事項

●本キットは ELISA 法の研修を終了した方、または指導者の下でご使用下さい。

用手法操作で測定する際にはピペッティング操作の再現性が安定した方がご使用下さい。

●準備並びに本キット操作中は手袋、眼鏡、保護用着衣を身につけて下さい。

●試薬類を皮膚に付けないで下さい。本キットの試薬が誤って、目、口、傷口、皮膚等に付着した場合は直ちに水道水で充分に洗い流す等の応急処置を行い、必要な場合は医師の手当てを受けて下さい。

●本キットを使用している場所では飲食や喫煙をしないで下さい。

●検体は感染の危険性があるものとして充分注意して取り扱って下さい。本キットは動物由来の成分を含んでいます。

●使用済みの検体、使用した消耗品等は 1%ホルマリン、2%グルタールアルデヒドまたは 0.1%以上の次亜塩素酸ナトリウム溶液に 1 時間以上浸けて下さい。またはオートクレーブ滅菌処理して廃棄して下さい。使用した消耗品や未使用の薬品類は所属施設の規定並びに各地域の法令に従って廃棄して下さい。

●試薬類は口でピペッティングしないで下さい。

●ロット番号の違う試薬とは混ぜて使わないで下さい。

●各ステップでの静置反応時には、ウエルの乾燥、異物の混入、温度の偏り、分注試薬の蒸発を防止する為、必ずプレートシールを貼って下さい。

●ELISA 法は測定環境により影響を受けます。測定操作、静置反応場所の室温：20～25℃（実験台上またはインキュベータ内温度）を厳守して下さい。また、風速（エアコン風も含む）：0.4m/sec（*①）以上、湿度 30%未満の環境下での測定は避けて下さい（9.技術上のヒントをご参照下さい）。
（*①）：風速 0.4m/sec の目安は弊社 Web サイトの動画**「反応条件」**をご参照下さい。

6. 構成品

構　成　品	状　態	容　量
（A）抗体固相化ウエルプレート	洗浄後使用	60wells（6×10）（＊②）／1 枚
（B）標準プロインスリン溶液（200pmol/L）	希釈後使用	100μl／1 本
（C）緩衝液	そのまま使用	60ml／1 本
（D）ビオチン結合抗プロインスリン抗体	希釈後使用	100μl／1 本
（E）ペルオキシダーゼ・アビジン結合物	希釈後使用	100μl／1 本
（F）発色液（TMB）	そのまま使用	12ml／1 本
（H）反応停止液（1M H_2SO_4）　※取扱注意	そのまま使用	12ml／1 本
（Ｉ）濃縮洗浄液（10×）	希釈後使用	100ml／1 本
プレートシール		4 枚
取扱説明書		1 部

（＊②）：プレートは 96 ウエル（8×12）がセットされています。ご使用時は外周のウエルを使用しないで下さい。11.ワークシート例をご参照下さい。抗体の固相化は 96 ウエル全てされています。

7.添付されていないが必要な器具　□チェックリスト

□精製水（蒸留水）
□標準溶液希釈用試験管
□洗浄液希釈用ガラス器具（メスシリンダー・ビーカー・瓶）
□チップ交換型ピペット（使い捨てチップで 10μl、20μl を正確にピペッティングできるもの、及び 200～400μl を正確にピペッティングできるもの）
□連続分注ピペット（例 Eppendorf の multipette plus）、50μl を連続分注できるもの
□ペーパータオル等の吸水性のあるもの（洗浄後にプレートに残った液を取り除く）
□撹拌器（Vortex タイプ）
□マイクロプレート振とう器（約 600～1,200 rpm）
□96 ウエルプレート用洗浄機（あれば好ましい）または噴射ビン（弊社 Web サイトの動画**「洗浄操作」**をご参照下さい。）
□96 ウエルプレートリーダー（450 ±10 nm 、620nm：600～650nm）
□データ計算用ソフトウェア

8.試薬の調製

＊キットの試薬は使用前に必ず室温（20～25℃）に戻して下さい（2 時間位が目安です）。
＊6.で「そのまま使用」とある試薬は室温化後そのままの状態で使用できます。「希釈後使用」とあるものに

ついては下記の要領で調製して下さい。
＊測定に必要な分だけ試薬を調製して下さい（ご不明な際にはお問い合わせ下さい）。

【濃縮された試薬類】

［(B)標準プロインスリン溶液（200 pmol/L）］;標準曲線作製用

（B）標準プロインスリン溶液（200pmol/L）（原液）と（C）緩衝液を使って標準溶液を調製して下さい。下記は一例です。※換算は 1ng/ml=106pmol/L（マウス）で行っております。

標準溶液の容量	緩衝液	濃度（pmol/L）	濃度（pg/ml※）
原液 20μl	380μl	10	94.3
10 pmol/L 溶液 200μl	200μl	5.0	47.2
5.0 pmol/L 溶液 200μl	200μl	2.5	23.6
2.5 pmol/L 溶液 200μl	200μl	1.25	11.8
1.25 pmol/L 溶液 200μl	200μl	0.625	5.89
0.625 pmol/L 溶液 200μl	200μl	0.313	2.95
0.313 pmol/L 溶液 200μl	200μl	0.156	1.47
0（ブランク）	200μl	0	0

□で囲まれた濃度の標準溶液を使用して測定して下さい。

［(D)ビオチン結合抗プロインスリン抗体］

100μl を充分分取できる量をご提供しています。
濃縮液を（C）緩衝液で 100 倍に希釈して下さい。

［(E)ペルオキシダーゼ・アビジン結合物］

100μl を充分分取できる量をご提供しています。
濃縮液を（C）緩衝液で 100 倍に希釈して下さい。

［(I)濃縮洗浄液(10×)］

濃縮洗浄液（10×）を室温化された精製水（蒸留水）で 10 倍に希釈して下さい。
例：100ml の濃縮洗浄液（10×）＋900ml の精製水（蒸留水）（96 ウエル全てを使用する場合）

【試薬の安定性と保存方法】

(A)抗体固相化 96 ウエルプレート

未使用(冷蔵状態を保った状態でシールを剥がしていない)抗体固相化ストリップは同梱のジップシールパックに戻し、そのまま 2～8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。

(B)標準プロインスリン溶液(200 pmol/L)

キットを分割して使用する際は使用する直前に冷蔵庫より取り出し希釈調製し、残りの原液は室温に戻さないで直ちに蓋をしっかりと閉め、2～8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。希釈した各標準溶液は直ちに使用し、保存はしないで下さい。

(C)緩衝液及び(F)発色液(TMB)

一部の溶液を使用する際は必要量より少し多めの量を別の容器に移し、残りは室温に戻さないで直ちに蓋をしっかり閉め、2～8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。

(D)ビオチン結合抗プロインスリン抗体及び(E)ペルオキシダーゼ・アビジン結合物

キットを分割して使用する際は希釈時に冷蔵庫より取り出し希釈調製し、残りの原液は室温に戻さないで直ちに蓋をしっかりと閉め、2～8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。使用残りの希釈済み液は廃棄して下さい。

(H)反応停止液(1M H_2SO_4)

使用残りを保存する場合は、蓋をしっかりと閉め、2～8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。

(I)濃縮洗浄液(10×)

濃縮洗浄液(10×)を保存する場合は、蓋をしっかりと閉め、2～8℃で保存して下さい。有効期限内安定性を保ちます。使用残りの希釈済み洗浄液は廃棄して下さい。

9.技術上のヒント

●検体と試薬に不純物が混ざらないように気をつけて下さい。1 ウエル／1 チップのご使用をお薦めします。
●発色液は 96 ウエルプレートに使用するまではほぼ無色または薄い黄色澄明です。光を避けて保存して下さい。
●反応停止液は使用するまでは無色です。

●やむを得ず、測定操作を、風速：0.4m/sec 以上、湿度 30%未満の環境下で実施する場合には、各ステップの静置反応時、プレートシールをすることに加え、下記のような方法をご検討下さい。
例）インキュベータ内、発泡スチロール製箱内で静置反応させる等。測定室の環境条件により対策方法が異なる場合がありますので、詳細を弊社 Web サイトの動画「反応条件」でご確認下さい。

10.検体の調製

本キットはマウスまたはラットの血清または血漿中のプロインスリンを測定します。

●検体は採取後すぐに測定するか、－35℃以下で凍結保存して下さい。凍結した検体は測定する直前に解凍し充分に撹拌して下さい。繰り返しの凍結融解は避けて下さい。正しい結果が得られない原因になります。

●溶血した検体や高脂質検体は異常値の発生原因となりますので避けて下さい。

※血液成分の影響（高脂質・溶血等）を抑制する為に原検体中の脂質（乳ビ）・溶血が次項写真より高い場合は異常値発生の原因となる場合がありますので測定に使用しないで下さい。
本キットの場合、溶血は 80mg/dL 以上で影響が現れます。

正常検体　溶血検体　正常検体　溶血検体
80mg/dL　80mg/dL

正常検体　乳ビ検体　正常検体　乳ビ検体
（高脂質検体）　（高脂質検体）

●濁り及び不溶物のある検体は遠心分離等で除去後測定に用いて下さい。

●妨害物質の影響が疑わしい検体は、同一検体において、異なる 2 ポイント以上の希釈率で希釈直線性を確認して下さい。

●検体を希釈する場合は、あらかじめ試験管等を用いて緩衝液で希釈し測定ウエルに分注して下さい。

●**標準操作法では 5 倍希釈です。また、最小希釈倍率は 2.5 倍です。**濁り及び不溶物のある検体は遠心分離等で除去後測定に用いて下さい。

【検体の安定性と保存方法】

プロインスリン分解酵素等のプロテアーゼの働きを抑えるため、採血時に最終濃度が 100～500KIU/ml のアプロチニンを添加して保管することをお薦めします。また、長期に保管する場合は、-35℃以下での凍結保管を推奨します。繰り返しの凍結融解は避けて下さい。(KIU：kallikrein inhibitor unit)

ポジティブ検体による測定検体の適合性テスト

これから測定されようとしている検体が本キットの検体としての条件を満たしているかどうかを調べることは、万一期待された測定結果が出なかった場合の原因究明に役立ちます。一般的に測定検体は様々です。例えば、採血の際の麻酔の有無、麻酔薬の種類、血漿を採取する場合に使用した抗凝固剤、検体が常温、低温で放置されていた間に起きた炭酸ガスの消失と pH の上昇、保存剤として加えられた薬物、保存中に起きた血液成分の濃縮、変性などの要因が測定検体には加わっています。このような要因の為に測定検体が本キットの反応系に影響していないかどうかを、できればアッセイ毎に調べたいものです。

実行方法

適当に選んだ代表的検体、例えば対象群の検体の一つから 90μl(＊③)を小試験管に採り分けます（採った検体の番号を記録しておいて下さい。仮に No. C とします）。次に標準溶液の系列から最高濃度の溶液を 10μl 採って小試験管内の検体に加え、よく撹拌します。こうして作製した標準品入りの検体をポジコンとして他の検体と共に測定します。この測定値を検体 No. C の測定結果と比べて見て下さい。もしも、No. C の測定値が A ng/ml であったとすると標準品入り検体の測定値は測定精度の範囲内で、A ×0.9＋(最高標準溶液濃度×0.1)ng/ml になっている筈です。要するに簡単な添加回収試験を行っている訳です。測定検体がこの条件を満たしていれば、本キットの測定系が検体に対して満足に機能していることが証明される訳です。

(＊③)90μl がピペットの都合で採取できない場合は 100μl 採っても結構です。それに標準溶液 10μl を加えた場合、期待測定値は、A ×0.91＋(最高標準溶液濃度×0.09)になる筈です。検体が少なくて 90μl は無理だという場合には、(50μl＋5μl)の組み合わせでも良いでしょう。もっと少量の組み合わせではピペットの精度の問題があって測定値の信頼性が疑問になります。

11.測定操作法

洗浄操作を始める前に次に分注する試薬を前もって用意して下さい。

抗体固相化プレートのシールは、プレートが充分に室温に戻ってから剥がして下さい。

(1) あらかじめ調製した洗浄液を各ウエルに満たし 4 回洗浄(*④)します。その後ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
(2) 検体測定ウエルに緩衝液を 40μl ずつ分注し、さらに検体を 10μl 添加します。
(3) 標準品測定ウエルに各濃度の標準溶液を 50μl ずつ分注します。
(4) マイクロプレート振とう器などを用いて撹拌(*⑤)します。
(5) プレートシールを貼り(＊⑥)、室温(20～25℃)で **2 時間**静置します。
(6) 反応終了後、反応液を捨て洗浄液を各ウエルに満たし、4 回洗浄(*④)します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
(7) 各ウエルにビオチン結合抗プロインスリン抗体を 50μl ずつ分注します。マイクロプレート振とう器などを用いて撹拌(*⑤)します。
(8) プレートシールを貼り(＊⑥)、室温(20～25℃)で **2 時間**静置します。
(9) 反応終了後、反応液を捨て洗浄液を各ウエルに満たし、4 回洗浄(*④)します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
(10)各ウエルに、ペルオキシダーゼ・アビジン結合物を 50μl ずつ分注します。マイクロプレート振とう器などを用いて撹拌(*⑤)します。
(11)プレートシールを貼り(＊⑥)、室温(20～25℃)で **30 分間**静置します。
(12)反応終了後、反応液を捨て洗浄液を各ウエルに満たし 4 回洗浄(*④)します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
(13)各ウエルに発色液を 50μl ずつ分注します。マイクロプレート振とう器などを用いて撹拌(*⑤)します。
(14) プレートシールを貼り(＊⑥)、室温(20～25℃)で **30 分間**静置します。
(15)各ウエルに反応停止液を 50μl ずつ分注し、発色反応を停止します。
(16)撹拌(*⑤)後マイクロプレート用分光光度計で 450nm(副波長 620nm)での吸光度を測定します。副波長は 600～650nm の範囲で使用できます。

(＊④)、(＊⑤)、(＊⑥)測定手順概要(7 ページ)をご参照下さい。

ワークシート(例)；灰色部分のウエルは測定には使用しないで下さい。

	Strip 1	Strip 2&3	Strip 4&5	Strip 6&7	Strip 8&9	Strip 10&11	Strip 12
A							
B		10 pmol/L	ポジコン	検体 6	検体 12	検体 18	
C		2.5 pmol/L	検体 1	検体 7	検体 13	検体 19	
D		1.25 pmol/L	検体 2	検体 8	検体 14	検体 20	
E		0.625 pmol/L	検体 3	検体 9	検体 15	検体 21	
F		0.156 pmol/L	検体 4	検体 10	検体 16	検体 22	
G		0	検体 5	検体 11	検体 17	検体 23	
H							

12.計算

(1) 測定毎に標準曲線を作製します。片対数を使用し X 軸(Log 側)を標準溶液濃度(pmol/L)、Y 軸を吸光度の標準曲線グラフを作製して下さい。
(2) 標準曲線より、検体の吸光度に対応する濃度(pmol/L)を読み取ります。読み取った濃度に検体希釈率(本測定法では 5 倍)を乗じ測定値とします。

- ●検体の吸光度が標準曲線吸光度より外れた場合は(C)緩衝液にて適当倍率に調製し再度測定を実施して下さい。
- ●コンピュータソフトでの演算処理では、3 次多項式または 4 パラメーターの使用をお薦め致します。
- ●マウスまたはラットの臨床所見は臨床症状や他の検査結果などを総合的に判断して行う事が必要です。

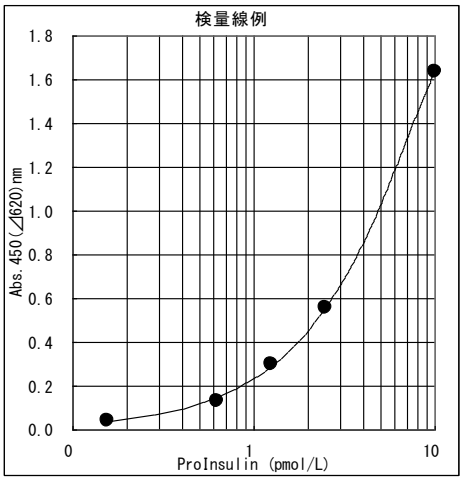

●キット添付標準溶液はマウス由来です。
右のグラフは標準曲線例です（吸光度は、測定環境により変動します）。
＊プレートリーダーは Safire2(TECAN)を使用

13.キットの性能

●測定範囲
マウスまたはラットプロインスリンを 0.156～10 pmol/L（標準曲線範囲）の範囲で測定できます。
標準操作法の 5 倍希釈時は実効測定範囲は 0.78～50 pmol/L となります。

●特異性
関連物質を本キットで測定した結果は次表のとおりです。

検体名	交差性	検体名	交差性
マウス　プロインスリン	100%	ラット プロインスリン	100%
マウス　インスリン	－	ラット インスリン	－
マウス　C-ペプチド	－	ラット　C-ペプチド	－

※交差性は、10 pmol/L 濃度時のデータです。－：交差無し

●精度試験（アッセイ内変動）（5 重測定、2 検体）　　平均 C.V.値は 5%未満
●再現性試験（アッセイ間変動）（2 重測定、3 検体、4 日間）　平均 C.V.値は 5%未満
●添加回収試験
2 血清検体に異なる 3 濃度のプロインスリンを添加し測定した結果、回収率は 92.5%から 109%でした。
●希釈直線性
2 血清検体を連続的に希釈用緩衝液で 3 段階希釈し測定した結果、直線回帰の R^2 は 0.9994 から 0.999 でした。

14.参考値

マウスプロインスリン測定値　：平均 2.46 pmol/L、標準偏差　0.598 pmol/L
　亜種　：BALB/c、雌、8 週齢、不断給餌、5 匹、血清
ラットプロインスリン測定値　：平均 3.31 pmol/L、標準偏差　1.48pmol/L
　亜種　：GK、雄、16 週齢、不断給餌、7 匹、血清
飼育条件、採血条件、検体保管条件により測定値は変動します。この測定値は目安としてお使い下さい。

15.トラブルシューティングと Q&A

●すべてのウエルでの反応が弱い
可能な解釈
1）標準品や検体の入れ忘れ。
2）発色に関連する試薬溶液の入れ忘れ。
3）発色に関連する試薬溶液の取り違えや希釈調製不良。
4）酵素阻害剤の混入。
5）キット保管温度の影響（凍結した場合）。
6）プレートの過剰な洗浄。
7）発色液の温度が低かった。

●最小標準溶液濃度(0.156 pmol/L)の OD 値よりブランク OD 値が高くなる
可能な解釈
洗浄が不適当、不完全であった。
（ペルオキシダーゼ・アビジン結合物と反応後の洗浄回数 4 回を同じ流速で 5～8 回に増やして下さい。）

●変動係数（CV）が大きい
可能な解釈
1）洗浄が不適当、不完全であった。
2）標準品や管理血清、または検体の撹拌が不充分であった（凍結検体の撹拌は充分に行って下さい）。
3）ピペッティング操作が一定ではなかった。

●Q-1　：キットは分割して使用することができますか？
A-1　：できます。プレートに貼られた透明シールをストリップの間にそってカッターなどで切り離してご使用下さい。使用しないプレートはシールを貼った状態で冷蔵庫に保管して下さい。

●Q-2　：プレートを取り出したらウエルの中に液体が入っていましたが何ですか？

A-2　:出荷時には保存安定液が充填してあります。
●更に詳しいトラブルシューティングや Q&A は弊社ホームページをご覧下さい。

【測定手順概要とチェックリスト】

必ず取扱説明書を一読して検体条件、測定条件、測定方法を確認後測定操作を行って下さい。
操作法は弊社 Web サイト[良い結果を出すためのポイント(動画)] 並びに「Q&A」をご参照下さい。

□　ウエルプレート、試薬類を充分に室温(20～25℃)に戻して下さい。室温化には 2 時間位必要
□　濃縮洗浄液の希釈　：室温化された精製水で、10 倍に希釈して下さい。
□　標準溶液の希釈(例)：室温化された緩衝液で、希釈して下さい。

濃度(pmol/L)		10	5.0	2.5	1.25	0.625	0.313	0.156	0
標準溶液(μl)	原液:20		200*	200*	200*	200*	200*	200*	0
緩衝液(μl)		380	200	200	200	200	200	200	200

*：ひとつ高濃度の標準溶液

□　ポジティブ検体の作製

		各操作注意事項並びに関連情報
□	**抗体固相化ウエルプレート**	
□	↓洗浄 4 回(＊④)	洗浄液除去後、直ちに次の試薬分注
□	**希釈検体（緩衝液 40μl＋ 検体 10μl） または　標準プロインスリン溶液　50μl**	「ピペッティング」の動画参照
□	↓撹拌(＊⑤)、室温(20～25℃)、2 時間反応、静置(＊⑥) ⇨	第一反応「反応条件」の動画参照
□	ビオチン結合抗プロインスリン抗体の希釈 室温化された緩衝液で 100 倍に希釈して下さい。	希釈溶液の調製は第一反応中に行う
□	↓洗浄 4 回(＊④)	洗浄液除去後、直ちに次の試薬分注
□	**ビオチン結合抗プロインスリン抗体　50μl**	「ピペッティング」の動画参照
□	↓撹拌(＊⑤)、室温(20～25℃)、2 時間反応、静置(＊⑥) ⇨	第二反応「反応条件」の動画参照
□	ペルオキシダーゼ・アビジン結合物の希釈 室温化された緩衝液で、100 倍に希釈して下さい。	希釈溶液の調製は第二反応中に行う
□	↓洗浄 4 回(＊④)	洗浄液除去後、直ちに次の試薬分注
□	**ペルオキシダーゼ・アビジン結合物　50μl**	「ピペッティング」の動画参照
□	↓撹拌(＊⑤)、室温(20～25℃)、30 分間反応、静置(＊⑥) ⇨	第三反応「反応条件」の動画参照
□	↓洗浄 4 回(＊④)	洗浄液除去後、直ちに発色液分注
□	**発色液(TMB)**　TMB が室温化されていることを確認　**50μl**	分注後、濃度により青色に変色
□	↓撹拌(＊⑤)、室温(20～25℃)、30 分間反応、静置(＊⑥) ⇨	第四反応「反応条件」の動画参照
□	**反応停止液(1M H_2SO_4)**　強酸性につき取扱注意　**50μl**	分注後、濃度により黄褐色に変色
□	↓撹拌(＊⑤)	直ちに撹拌
□	**吸光度測定(主波長 450nm、副波長 620nm:600～650nm)**	副波長はプレート裏面の汚れ等をキャンセルします

(＊④) **洗浄液をウエルに分注後、手のひらの上で 10 秒ほど軽く振り廃棄します。**4 回連続洗浄後、ペーパータオル上にプレートを逆さにして叩き洗浄液を完全に除去します。洗浄液除去後の乾燥に注意して次の溶液を直ちに分注します。洗浄液をピペットで添加する際の液量目安は 300μl／ウエルです。万一、最小標準溶液濃度(0.156 pmol/L)の OD 値よりブランク OD 値が高くなる場合は解決方法の 1

つとして、ペルオキシダーゼ・アビジン結合物と反応後の洗浄回数 4 回を同じ流速で 5～8 回に増やして下さい。プレート洗浄機ご使用の場合の圧力目安は 5～25ml／分（ノズルの径により異なります）です。第一反応後の初回の洗浄のみウエル間のコンタミに注意して下さい。**「洗浄操作」**の動画をご参照下さい。

（＊⑤）撹拌の目安は 600～1,200rpm-10 秒間、3 回。**「撹拌操作」**の動画をご参照下さい。

（＊⑥）撹拌終了後プレートシールを貼り静置して下さい。**「反応条件」**の動画をご参照下さい。
プレートシールは保護紙を剥がして、粘着面をプレート側にして貼り付けて下さい。一度使用したプレートシールは再使用しないで下さい。

ワークシート；灰色部分のウエルは測定には使用しないで下さい。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

【測定名】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【所属】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【測定者】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【測定日】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【キットロット番号】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【有効期限】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【備考】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【製品名】　；レビス® プロインスリン-マウス/ラット

【コード番号】；AKMPI-111

【英語表記】；Mouse/Rat Proinsulin ELISA KIT(AKMPI-111,Shibayagi Co.,Ltd, Gunma,Japan)

【お問い合せ先】

製造／発売元；株式会社　シバヤギ
〒377-0007　群馬県渋川市石原 1062-1
TEL.0279-25-0279　　FAX.0279-23-0313
<E-mail>syc-info@shibayagi.co.jp
<URL>http://www.shibayagi.co.jp